



26  
PAD

21  
PAD


20  
PAD

18  
PAD

16  
PAD

# SIE KENNEN **IHRE WERTE**

Laden Sie sich die myCardioMEMS™ -App für noch mehr Sicherheit noch heute herunter.

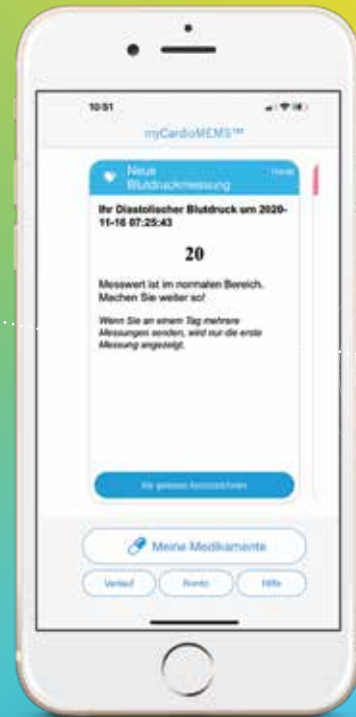

Abbott hilft Ihnen und Ihrem Arzt dabei, in Kontakt zu bleiben, und unterstützt Sie bei der Versorgung Ihrer Herzinsuffizienz. Denn Ihre Herzinsuffizienz sollte sich nicht einfach nur behandeln lassen. Die Versorgung Ihrer Herzinsuffizienz sollte sich wie eine Partnerschaft anfühlen. Deshalb möchten wir mit der myCardioMEMS™ -App sicherstellen, dass Sie Ihre Versorgung nicht aus den Augen verlieren.



## NOCH MEHR **KOMFORT.**

Die myCardioMEMS-App liefert Ihnen oder Ihrem Betreuer innerhalb weniger Minuten Ihren täglichen Pulmonalarteriendruck (PAD). Das ist genau der Wert, mit dem Ihr Arzt Ihre Herzinsuffizienz überwacht.

## ENGERE **KOMMUNIKATION.**


Sie erhalten von Ihrem Arzt eine Mitteilung, noch bevor Sie Symptome spüren oder ins Krankenhaus müssen. Dazu gehören mögliche Anpassungen Ihrer Lebensweise und Ihrer Medikation. Sie können auch einen „Betreuer“ für das Empfangen und Beantworten von Meldungen festlegen. Dieser hilft Ihnen zudem dabei, Ihre Versorgung zu überwachen.




Die myCardioMEMS™-App kann für Ihr iPhone® aus dem App Store® und für Ihr Android®-Gerät auf Google Play® heruntergeladen werden.

# MIT DER MYCARDIOMEMS™-APP KÖNNEN SIE:


**BENUTZERDEFINIERTE NACHRICHTEN MIT SPEZIFISCHEN ANWEISUNGEN** basierend auf Ihrer PA-Messung ERHALTEN.



**DEN MONATSVERLAUF DER ÜBERTRAGUNGEN** und Nachrichten von Kliniken anzeigen.




**BENACHRICHTIGUNGEN VON IHRER KLINIK** empfangen, um Ihre Herzinsuffizienz-Medikamente basierend auf Ihren PA-Druckwerten anzupassen.



**DEN ECHTZEIT-ÜBERTRAGUNGSSTATUS** IHRER CardioMEMS™ HF-Systemwerte sehen.



**ERINNERUNGEN** zur Einnahme Ihrer Herzinsuffizienz-Medikamente erhalten.

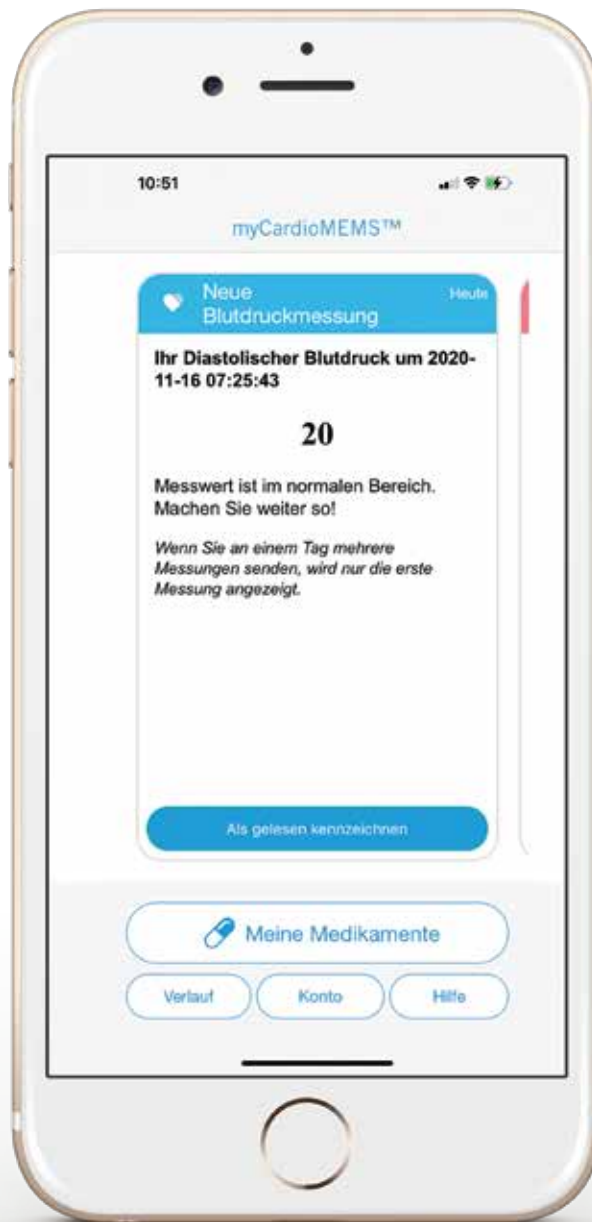

**IHREN PA-DRUCKWERT SEHEN – DIE ZAHL, MIT DER IHR ARZT IHRE HERZINSUFFIZIENZ ÜBERWACHT.**

**DANK UNSERER TUTORIALS SIND SIE SCHNELL EINSATZBEREIT**

**ABBOTT**  
The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box FL, 1935 Zaventem, Belgien,  
Tel: +32 2 774 68 11 | Cardiovascular.abbott

**HINWEIS:** Bitte machen Sie sich vor Gebrauch dieser Produkte unbedingt mit den Gebrauchsanweisungen und den darin enthaltenen Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, potenziellen Komplikationen und Hinweisen zum Gebrauch vertraut.

**INDIKATIONEN UND ANWENDUNG:** Das CardioMEMS™ HF-System ist indiziert zur kabellosen Messung und Überwachung des Pulmonalarteriendruckes (PA-Drucks) sowie der Herzfrequenz bei Patienten mit Herzinsuffizienz der Klasse III der New York Heart Association (NYHA), bei denen im vorausgegangenen Jahr eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz erforderlich war. Die hämodynamischen Messwerte werden vom Arzt für das Herzinsuffizienz-Management verwendet, um herzinsuffizienzbedingte Hospitalisierungen zu reduzieren.

**KONTRAINDIKATIONEN:** Das CardioMEMS HF-System ist kontraindiziert bei Patienten, bei denen eine einmonatige duale Plättchenhemmung oder eine orale Antikoagulation nach der Implantation nicht in Frage kommt.

**POTENZIELLE KOMPLIKATIONEN:** Zu den möglichen unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit dem

Implantationsverfahren gehören u. a.: Infektion, Arrhythmien, Blutungen, Hämatom, Thrombus, Myokardinfarkt, transienter ischämischer Anfall, Schlaganfall, Tod und Implantatembolisation.

**EINSCHRÄNKUNGEN:** Patienten müssen ihr eigenes Apple®- oder Android®-Gerät verwenden, um Informationen von der myCardioMEMS™-App zu empfangen und an diese zu übertragen. Dazu muss das Gerät eingeschaltet und die App installiert sowie eine Verbindung für den Datenverkehr (Mobilfunk oder WLAN) verfügbar sein. Die myCardioMEMS™-App kann eine Benachrichtigung über Medikamentenanpassungen und -erinnerungen, Anfragen für Laborarbeiten und die Bestätigung des Eingangs der PA-Druckwerte bereitstellen. Zahlreiche interne und externe Faktoren können jedoch den Empfang und Versand der Benachrichtigungen und Patientendaten gemäß den ärztlichen Einstellungen beeinträchtigen, verzögern oder verhindern. Dazu gehören Patientenumgebung, Datendienste, Betriebssystem und Einstellungen des Mobilgeräts, Klinikumgebung, Konfigurations- oder Übertragungsplanänderungen oder Datenverarbeitungsfehler.

™ bedeutet eine Marke der Abbott Unternehmensgruppe.

† bedeutet eine Marke eines Drittunternehmens, die das Eigentum des jeweiligen Besitzers ist.

© 2021 Abbott. Alle Rechte vorbehalten.

MAT-2012905 v1.0 | Dokument nur für die Verwendung in EMEA zugelassen.

